



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 52/1982


Udgave 1

Dato 1982-12-31

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-135 cs

MÅLEANLÆG

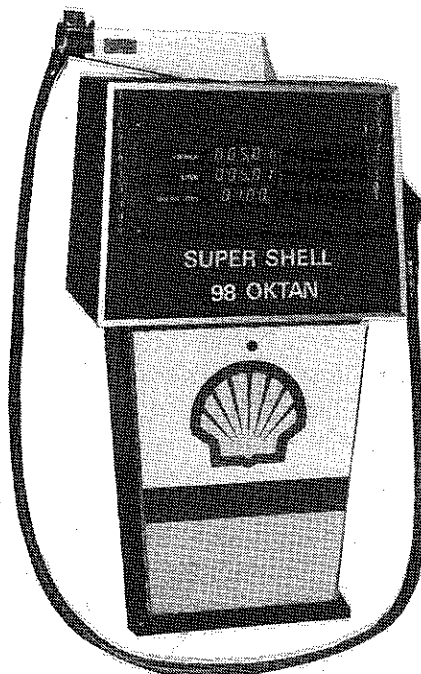

Fabrikant: Ljungman AB, Sverige og Koppens Automatic B.V. Holland.
Anmelder: Koppens Automatik Danmark ApS.
Art: Enkeltstander med elektronisk tællerværk.
Type: Ljungman/Koppens EPS 3c Ex.
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet: 50 l/min.

Mindste lovlige udmåling: 5 l

Tællerværk:

Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
Litertæller,	kapacitet	999,99 l
	deling	0,01 l
Dagspris,	kapacitet	9999 øre pr. l
	deling	1 øre pr. l

Justertolerance: ± 5 ‰

BEMÆRK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 52 /1982

Systembet.: IV-135 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering: Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter: Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Mindste lovlige udmåling 5 l.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv.nr., Fabr.nr., Max. l/min.

Mindste lovlige udmåling l.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Måleorgans 4 topstykker samt dæksel over reguleringsorgan på hvert topstykke og måleorgan til standers chassis.

På elektronikboxen sikres 2 frontdæksler imod åbning.

Elektronikbox og impuls giver sikres til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at foretage ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er identisk med den i justervæsenets bekendtgørelse nr. 343, systembetegnelse IV-59c beskrevne.

Dog er det mekaniske tælleværk erstattet med et elektronisk tælleværk af fabrikat Koppens, type EPS 3c Ex, som via en Koppens 2-kanal impuls giver, type PG03 er koblet til måleorgan.

Standeren er tilsluttet en central styringspult i kiosk, og indtil 16 standere kan tilsluttes denne.

Fra denne styringspult sættes literpriser og standernes ønskede arbejdsform såsom manuel betjenig, selvbetjening, kroneforvalg og literforvalg.

Seddelaautomat og kreditkortautomat kan tilsluttes.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1075/82, dateret 1982-03-18.

E. Repstorff Holtveg