

Industriministeriet
TEKNOLOGISTYRELSEN
SEKRETARIATET
FOR
MÅLETEKNIK

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1983-763/000-145


Udgave: 1

Dato: 1984-03-01

Gyldig til 1986-06-30

Systembetegnelse: IV-212cs

MÅLEANLÆG

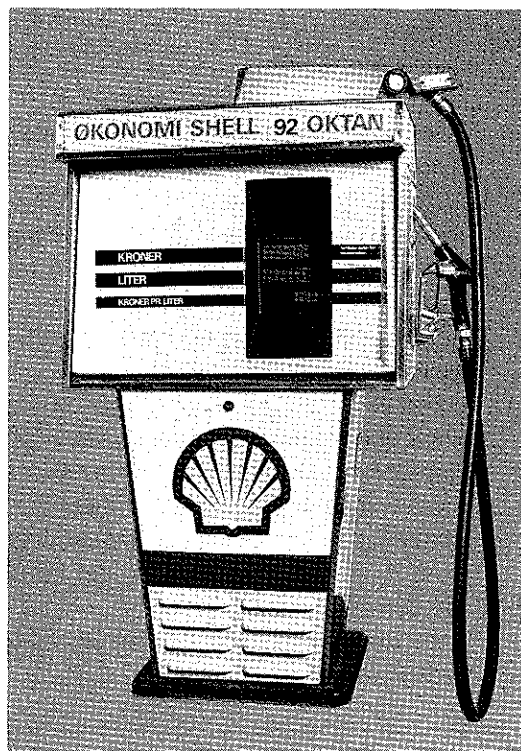

Producent

Tokheim/CR Card System A/S.

Ansøger

CR Card System A/S.

Art

Enkeltstander med elektronisk tælleværk.

Type

Tokheim 8500 cs.

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet

50 liter/min.

Mindste lovlige udmåling

5 liter

Tælleværk:

Pristæller,	kapacitet	9999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
Litertæller,	kapacitet	9999,99 liter
	deling	0,01 liter
Literpris,	kapacitet	99,99 kr. pr. liter
	deling	0,01 kr. pr. liter

Verifikationstolerance:

± 5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TEKNOLOGISTYRELSEN	TYPEGODKENDELSESATTEST	Nr.: 1983-763/000-145
		Systembet.: IV-212cs
<p>2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER</p>		
<p>Verifikation</p> <p>Påskrifter</p> <p>Plombering</p>	<p>Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.</p> <p>Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »ikke verificeret«.</p> <p>Skalaplade: Kroner, liter, kroner pr. liter. Verifikationen gælder kun detaillitertælleren. Ved synsglas: Glasset skal være fyldt.</p> <p>Verifikationsskilt: Til benzin, petroleum eller gasolie. Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr.nr., Max. liter pr. min. Mindste lovlig salg liter. Justeringen gælder kun detaillitertælleren.</p> <p>Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe. Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke: Måleorgans over- og underpart og kalibrators låsestift. Måleorganet sikres til standerens chassis. Det elektroniske tælleværks for- og bagside sikres imod åbning ved plombetråd igennem 2 skruer på hver side. Pladejernsboxen som det elektroniske tælleværk er placeret på, sikres imod åbning ved plombetråd igennem 2 huller i overpladen, videre igennem 2 huller i svøbet og ind under bundpladen og igennem 2 af de fire 6-kt. skruer, som fastspænder tælleværket til denne og endelig til standerens chassis. Teknologistyrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.</p>	
<p>3. KONSTRUKTION</p>		
<p>Standeren er en ombygget enkeltstander. Det hydrauliske system er identisk med det i bekendtgørelse nr. 402, systembetegnelse IV-83c beskrevne, bestående af pumpe med luftudskiller af fabrikat Tokheim model 855 og måleorgan af fabrikat Tokheim model 898. 2-kanal impulsgiveren er af fabrikat Scancon model 2A-100-5D og er placeret i en lukket pladejernsbox over måleorganet. Det elektroniske tælleværk, som har krone-, liter-, dagprisvisning på begge sider af standeren, vist på LCD-displays, er af fabrikat CR Card System, CS 8500-serien og er placeret ovenpå pladejernsboxen. Literprisen kan kun sættes fra kioskpult og højest tilladelige pris er 10,00 kr. pr. liter. I tilfælde af strømsvigt under tankning vil batteri back up holde standerens visning i min. 5 minutter.</p>		
<p>4. DOKUMENTATION</p>		
<p>Ansøgning nr. 1983-763/000-145, dateret 1983-10-21.</p> <p><i>J. Kaavé/P. Claudi Johansen</i></p>		